INcwb059V02_FR

713-058

CE

Charge maximale : 135 kg

IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ASSEMBLY INSTRUCTION

PART LIST

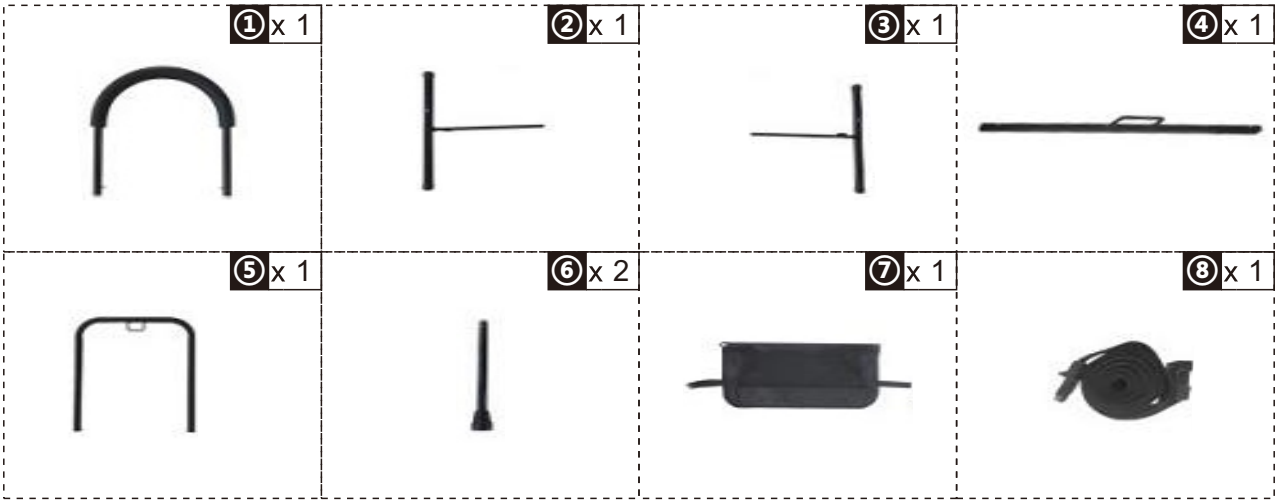

01

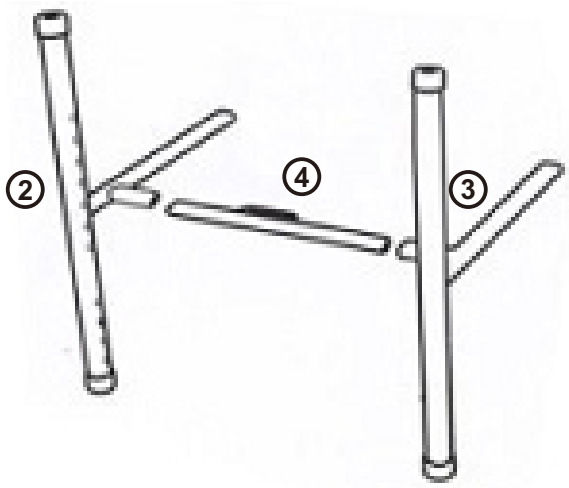

Utilisez la pièce ④ pour connecter la pièce ②and la pièce ③,Assurez-vous que le fermoir est bien fixé dans le trou.

02

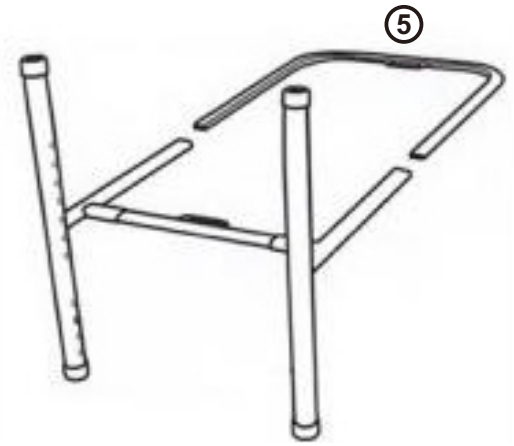

Relier les pièces 2 et 3 à l'aide des pièces 5,Assurez-vous que le fermoir est bien fixé dans le trou.

03

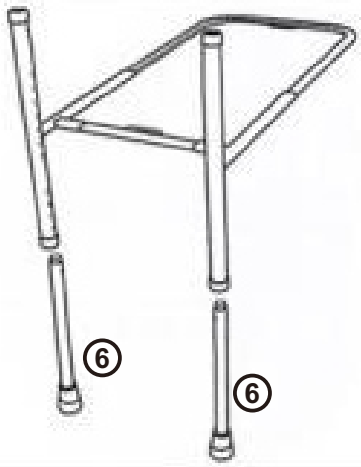

Raccorder les tuyaux avec le raccord 2,en prenant soin de régler la bonne hauteur et de s'assurer que les deux tuyaux sont sur la même ligne horizontale.

04

Installez les mains courantes et assurez-vous que le bouton-pression s'est bien logé dans le tuyau et que la hauteur correcte a été réglée.

05

Accrochez le sac et attachez le velcro aux tubes gauche et droit **(Pack pas plus de 5 kg).**

06

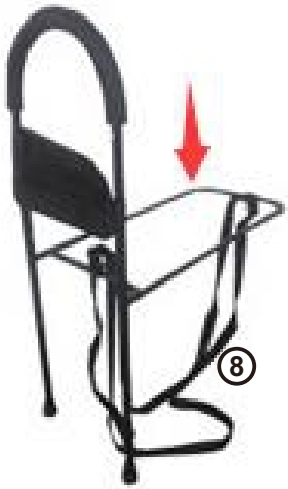

Placez le tube sous le matelas et enroulez la corde autour du matelas Fixez et attachez la corde au coussin.

Avertissement :

①:Veuillez vérifier si les accessoires sont au complet avant l'installation

②:Avant l'utilisation, assurez-vous que les attaches sont correctement installées et serrées, et que les clips sont à la même hauteur

③:Lors de l'utilisation, veillez à l'utiliser en douceur

④:Veuillez prêter attention à la sécurité lors de l'utilisation, si nécessaire, veuillez prévoir du personnel infirmier pour aider à l'utilisation

⑤:Après une certaine période d'utilisation, veuillez vérifier soigneusement si l'attache est desserrée, vérifier l'usure du coussinet, le remplacer à temps au besoin

Aosom